


No	サンプル名	回帰式	標準偏差 σ	相関係数
○ 1	PA・A	$Y = 470.067 \cdot X - 99.548$	0.35	0.9992
□ 2				
△ 3				
× 4				
◇ 5				
● 6				
▲ 7				
✖ 8				
■ 9				

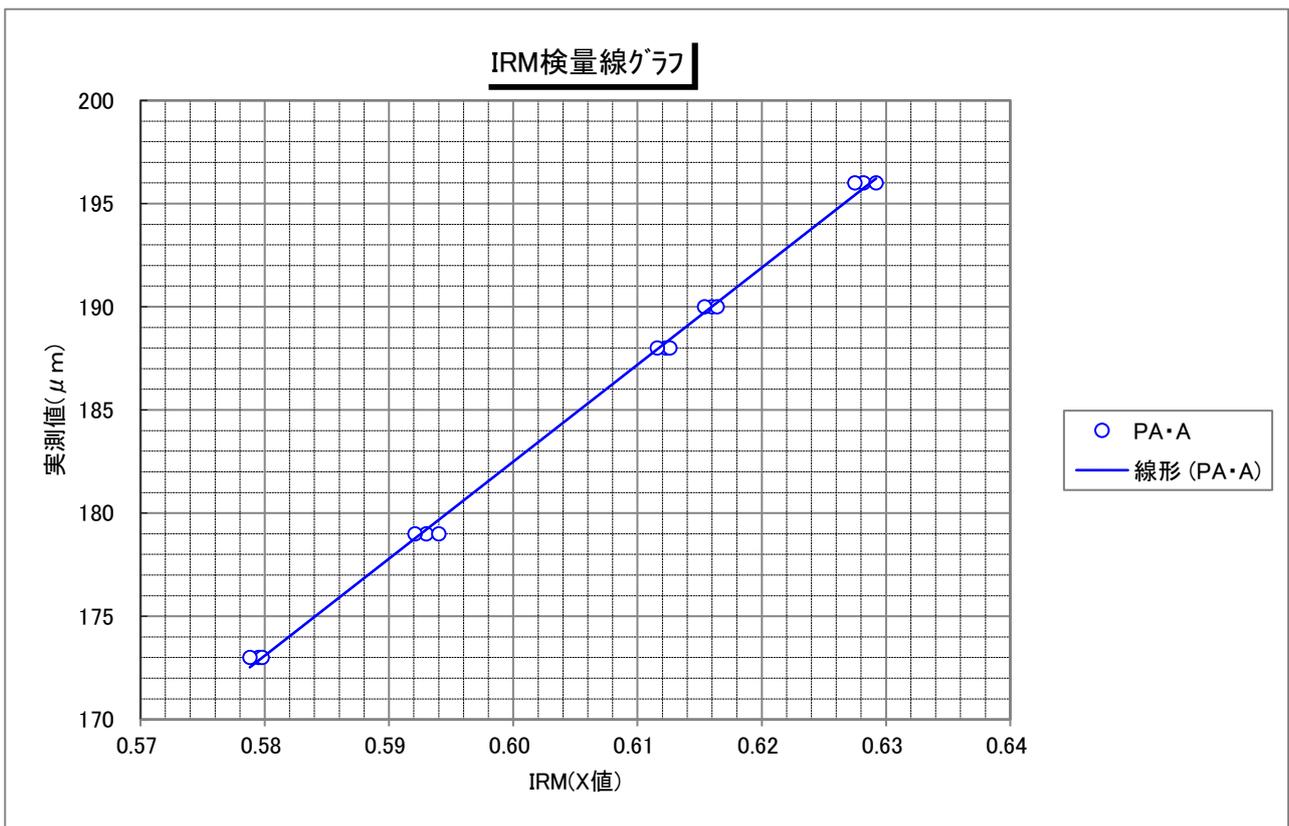

*検量線係数 $a_0 \sim a_3$ は回帰式の0~3次の係数に該当(有効桁数は5桁、それ以下は四捨五入)